

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automation Complete Blood Cell Analyser : CBC)
พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๓,๕๖๙,๕๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง): ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๕๖๙,๕๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการทดสอบ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณ (รายงานผลการทดสอบ ที่สมบูรณ์)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม ประมาณ (บาท)
๑	CBC	test	๑๒๑,๐๐๐	๒๙.๕๐	๓,๕๖๙,๕๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					๓,๕๖๙,๕๐๐.-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ตามแนวทางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวอำพรพรณ ไซยพันธ์ | ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางพิทมน ศรียา | ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวกมลวรรณ แสงสม | ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอำพรพรณ ไซยพันธ์)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิทมน ศรียา)


ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลวรรณ แสงสม)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

**ขั้นตอนการดำเนินการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
ของโรงพยาบาล/หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

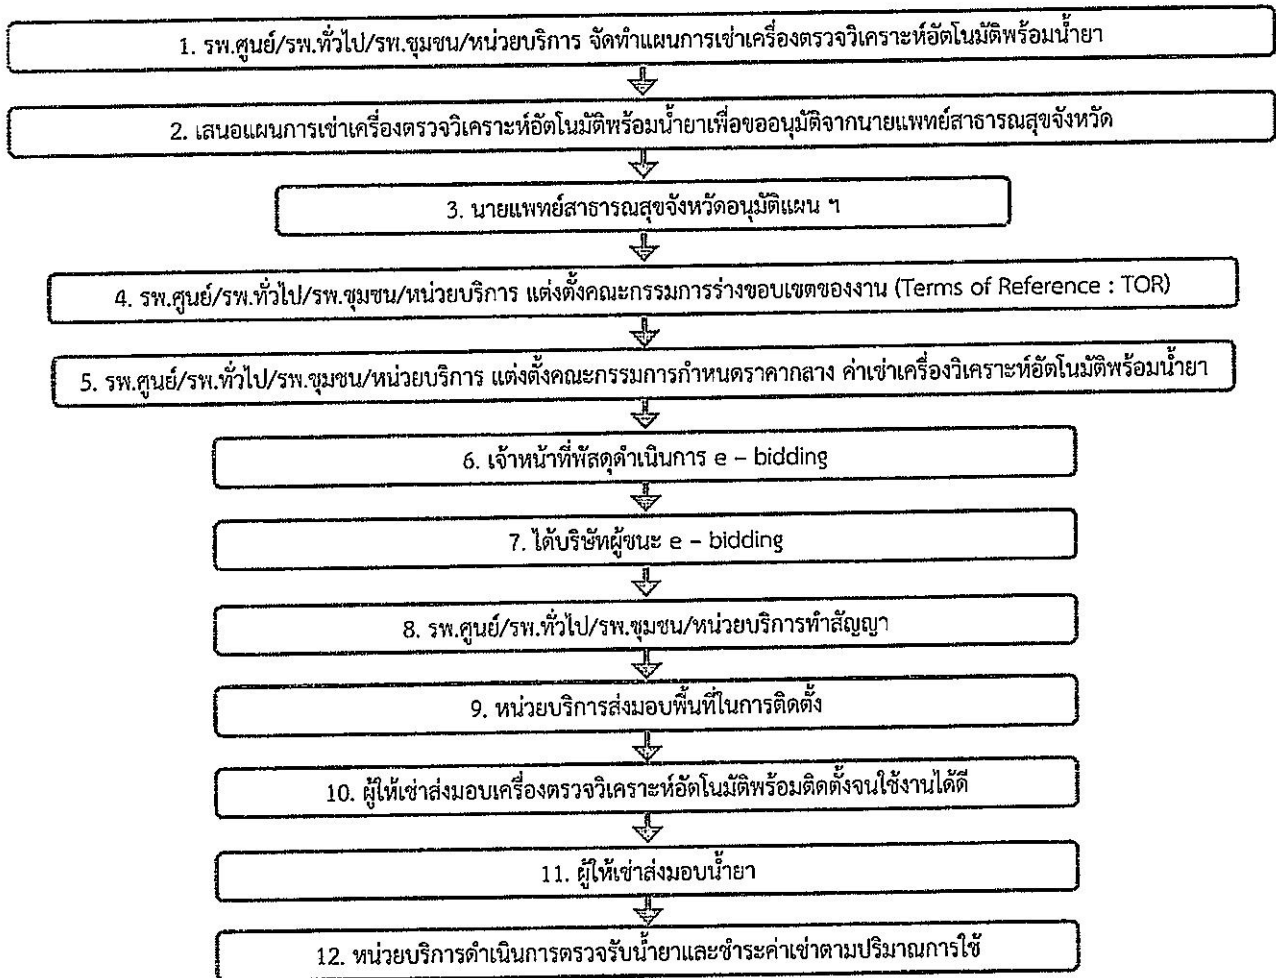

ราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา (บาท) /หน่วย		
			ระดับโรงพยาบาล		
			A,S	M1,M2,F1	F2,F3
1	CBC	Reportable	27.35	39.19	52.00
2	CBC with Slide maker (รวม สไลด์ และสีย้อม)	Reportable	34.88		
3	Blood gas	Reportable	117.00	195.00	
4	Electrolyte with chemistry analyzer	Reportable	33.06	56.00	72.00
5	Albumin	Reportable	5.48	9.50	12.32
6	ALP	Reportable	7.73	15.70	23.81
7	ALT	Reportable	7.84	16.00	27.02
8	Amylase	Reportable	38.15	60.00	88.00
9	AST	Reportable	7.89	16.20	27.48
10	Bilirubin; Direct	Reportable	7.12	15.23	25.61
11	Bilirubin; Total	Reportable	7.45	15.37	24.72
12	BUN	Reportable	5.80	10.97	16.29
13	Calcium	Reportable	9.59	18.21	32.24
14	Cholesterol	Reportable	7.79	13.20	19.08
15	CK-MB	Reportable	66.00	80.00	